HW-4 □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

1. □□□□ □□ □□□□□□ / □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ /□□□□ □□ □□□□□□ 2. □□□□
□□□□ □□ □□□ □□□□: 35.5 □□□□□□ □□□□□□□□ -42.9 □□□□□□ □□□□□□□□
3. □□□□□ □□ □□□ □□□□: 0 □□□□□□ □□□□□□□□-118 □□□□□□ □□□□□□□□
4. □□□-□□□□ □□□□□□□□
5. □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□
6. □□□□□□□□ □□□□□ □□□
7. □□□□□ □□□□ □□□□□
8. □□□□□ □□□□□□: 0 □□□□□□ □□□□□□□□-3.0 □□□□□□ □□□□□□□□
9. □□□□ □□□□□□ □□□□□□
10. □□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□: □□ 12470-5 □□ □□□□□□□ 1 965-98
□□□□ □□□□: 1 □□□□ -2 □□□□
□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□:
± 0.2 ℃ 35.5-42.0 ℃ ± 0.3 ℃ 42.1-42.9 ℃
□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□: ± 1 ℃ 0-118 ℃
□□□□□□: 0.1 □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□: 10.0 □□□□□□ □□□□□□□□ -40.0 □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ 80% □□□-□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□: -25.0 □□□□□□ □□□□□□□□ -55.0 □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ 0 9 0% □□□-□□□□□
□□□□□: 2 * □□□ □□□□□ □□□□ :: 41 □□□□ * 40 □□□□ * 152 □□□□
□□□□□ □□□: □□□□ 108 □□ (□□□□□ □□□□)

□□□□□□ □□□□□□□ .:
□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□
□□□□□□ / □□□□□□: 60 □□□□ / □□□□□□
□□□□□□□□□ /ctn: 12 □□□□
□□□□□□ □□□□: 56 * 39 * 33 □□□□
□□□□□□□□□□:
MOQ: 1000PCS
□□□ □□□□: 25 ~ 30 □□□
CE0499 □□ RoHS □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□: 20,000 □□□□ □□□□□ □□□□

Error less than or equal to ±0.2℃

1s accurate measure

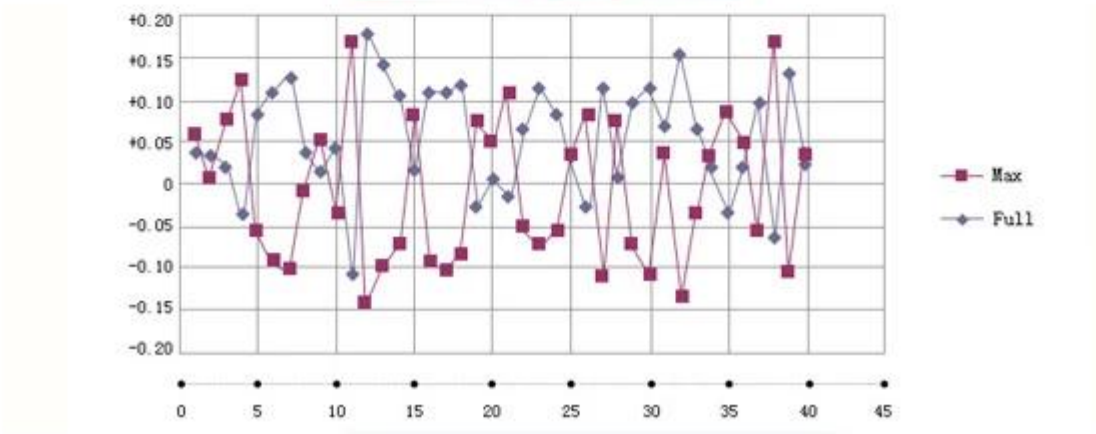

□□□□□□: sanieleung@dor-medex.com
□□□□□□□:thermometersupplier.com