製品の特徴:

高精度測定

口腔計測

スーパーサイズの液晶悲鳴

ブザー想起機能

基礎体温 (BBT) は排卵の日と排卵の後のより高い2つの段階から成っている。排卵後1 ‘2日は気温が高い範囲にシフトし、約2週間滞在します。その後、月経前に低下します。人の BBT の変化は数ヶ月にわたって BBT を記録することによって理解することができる。

あなたの BBT を記録するために、逆側の基礎体温チャートをコピーします。

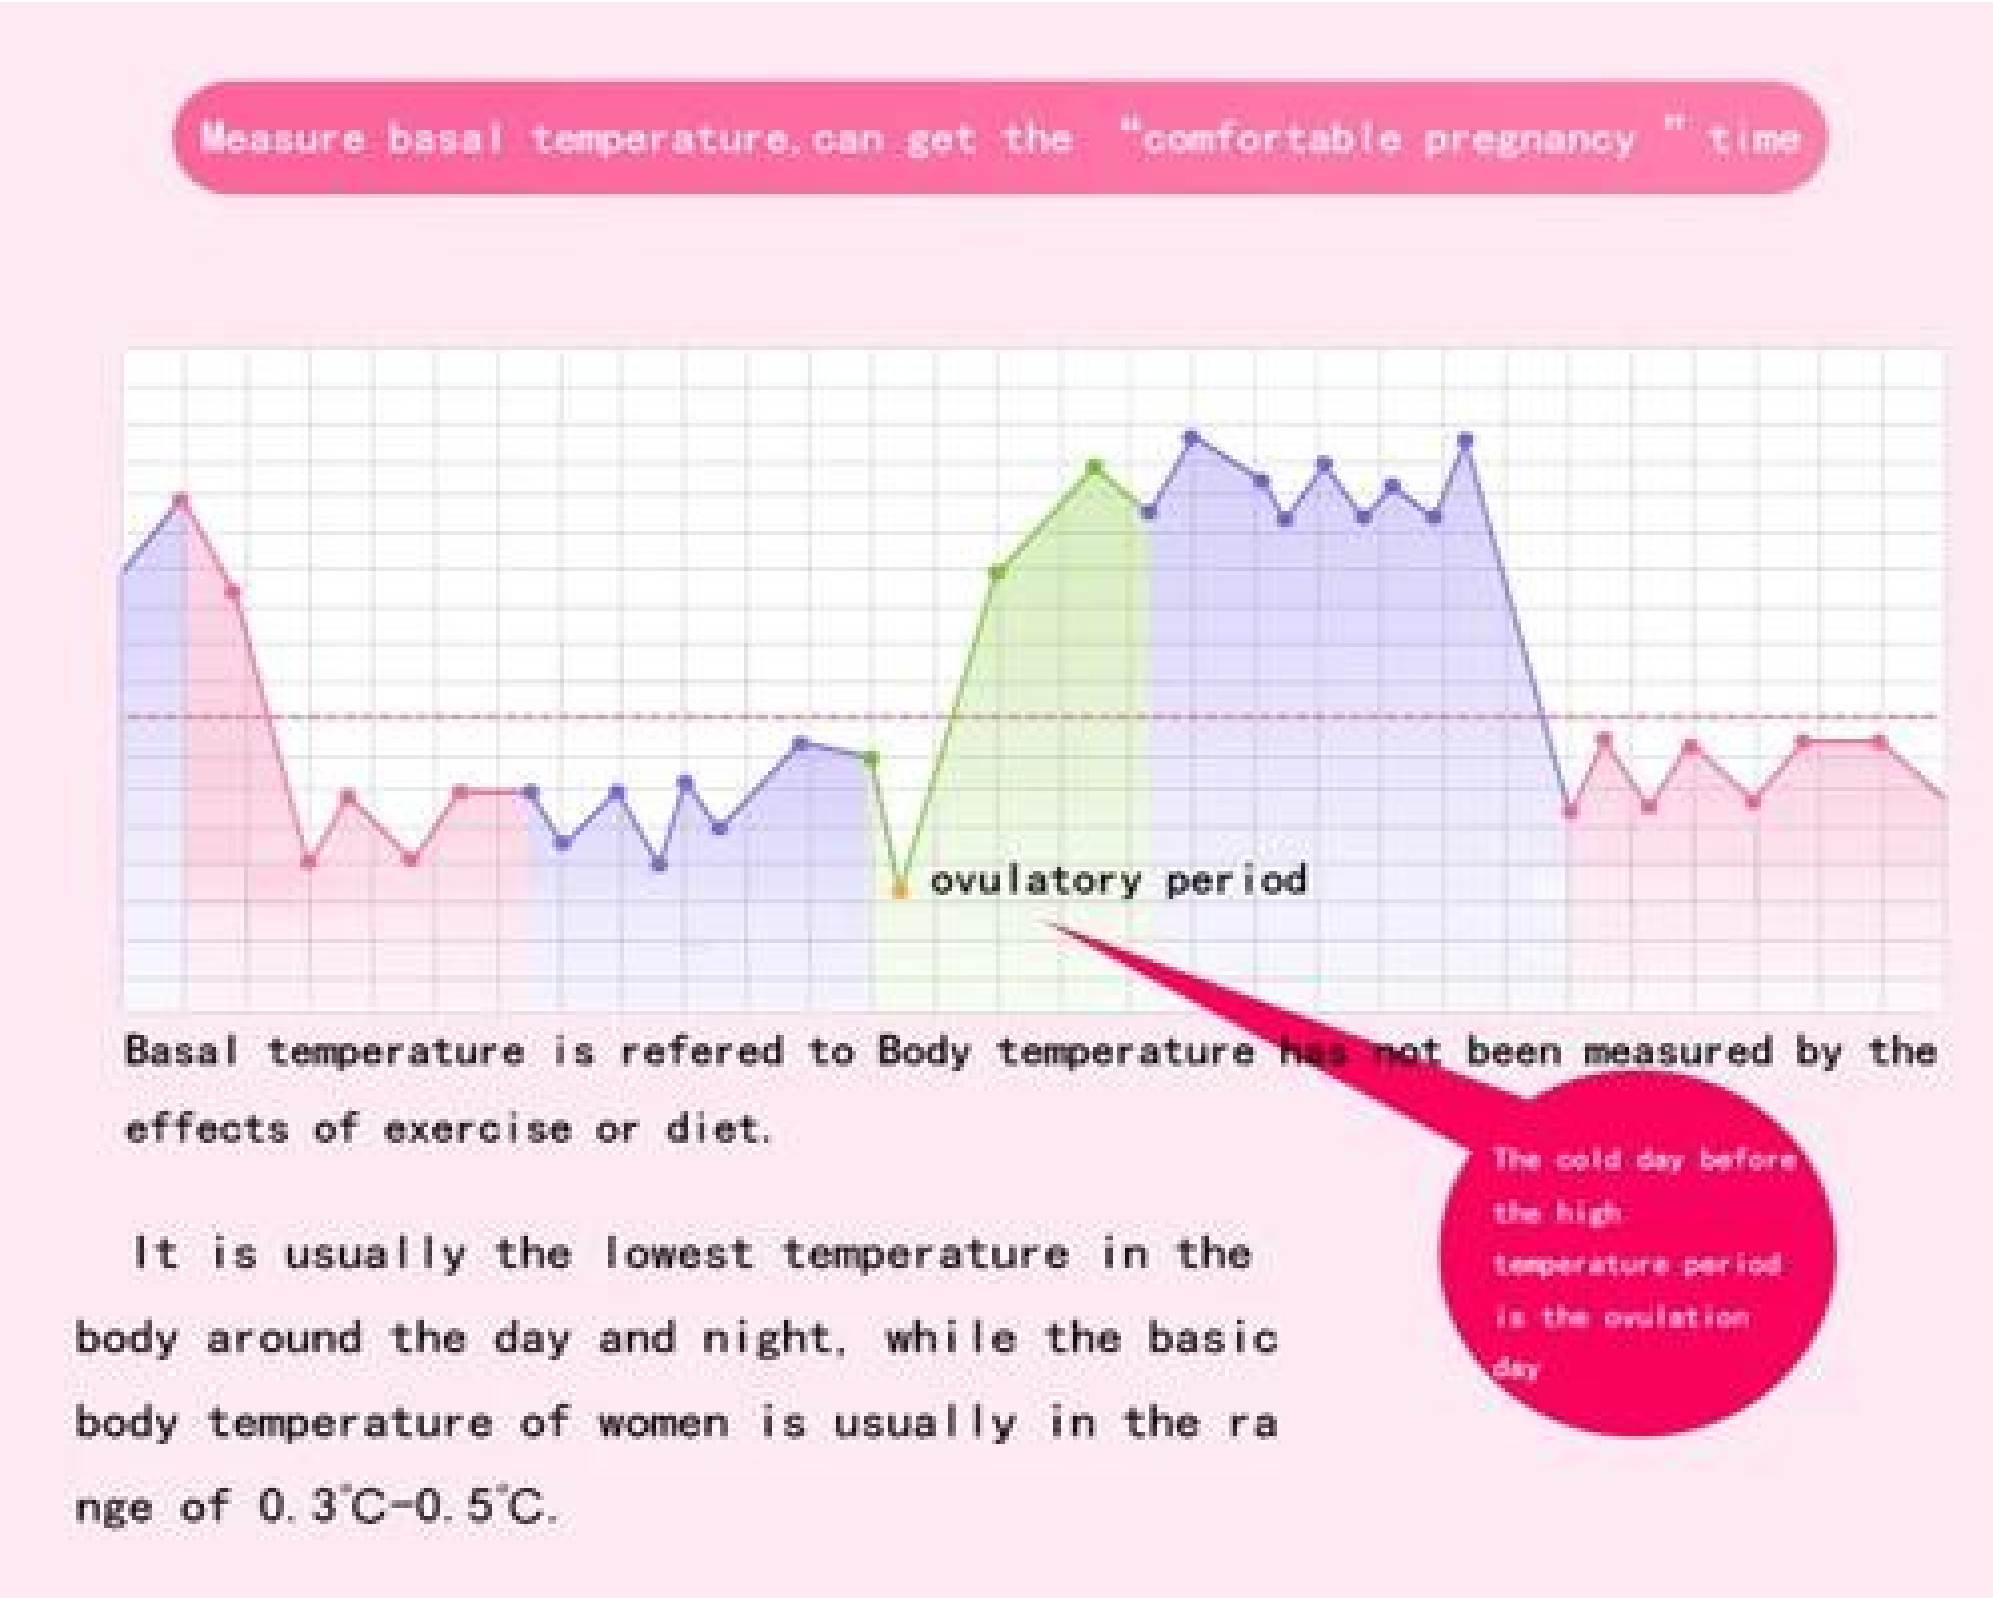

ovulatory period

Measure basal temperature, can get the “comfortable pregnancy ” time

Basal temperature is refered to Body temperature has not been measured by the effects of exercise or diet.

It is usually the lowest temperature in the body around the day and night, while the basic body temperature of women is usually in the range of 0.3℃-0.5℃.

The cold day before the high temperature period is the ovulation day

1.

LCD ディスプレイの横にあるオン/オフボタンを押します。トーンは、画面が示すように、最後のメモリの温度が続くと鳴ります。

自己テスト温度を示した後、温度計はテストモードになりました。

* 注: 測定温度が32℃または90℉未満の場合、lcd は Lo を表示しますが、測定された温度が42.9 ℃または109.9 ℉より高い場合、lcd は Hi を表示します。

ステップ.所望の位置に位置温度計 (□)

) 経口使用: "√" の位置で示されるように舌の下に温度計を配置します。あなたの口を閉じて、鼻を均等に呼吸吸入/呼気空気の影響を受けてからの測定を防ぐために。35.7 ℃と37.3 ℃ (96.3 ℉と99.1 ℉) の間の正常な温度

step3.

度記号は、テストプロセス全体で点滅します。点滅を停止すると、アラームは約10秒間鳴ります。測定された読書は LCD で同時に現われる。信号音 (ビープ音) が例外なく維持されるまでの最小測定時間。ブザー通知後も測定が続きます。温度計がテスト位置から外れた場合は、表示される気温は変わりません。

step4.

バッテリ寿命を延ばすには、オン/オフボタンを押して、テストの完了後にユニットをオフにします。アクションが実行されない場合、ユニットは around10 分後に自動的に遮断されます。
その保護ケースに温度計を保管してください。

Product information

name	thermometer	range	32—43°C
model	JT002BTS	humidity	-20°C+60°C≤85%RH
detector	thermistor	weight	15g(included battery)
temperature	Four digit display	size	20mm*130mm*13mm
accuracy	±0.05°C(36-39°C) ±0.2°C (32-35.99°C, 39.01-43°C) ±0.1°F (96.8-102.20°F) ±0.4°F(89.6-96.78°F, 102.2-107.6°F)		

Measure in a room temperature test tank at room temperature of 25 °C (77°F)

2
High sensitive thermistor temperature measurement
The advanced temperature sensing technology, aimed at the oral temperature measurement, can be measured in a minute to measure the body temperature
38
39
37
36.6 °C
40
36
41
35
42